



Общество с ограниченной ответственностью

243146, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 3У/1

ИНН/КПП 3241008153/324101001, р/с 40702810208120000028 в Брянском ОСБ №8605, БИК 041501601



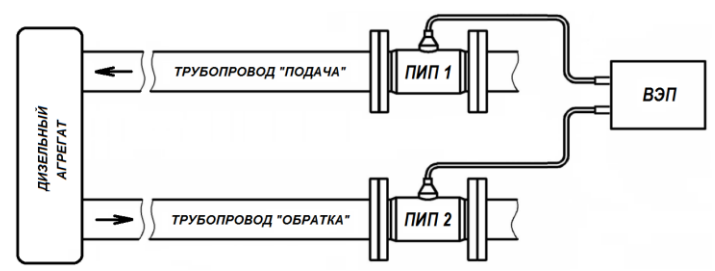

+7 (499) 703 23 11



info@potokomer.ru

Опросный лист для заказа расходомера-счётчика жидкости типа "РВШ-ТА"

(нужное дописать, или отметить квадратик ☐ галкой ☒):

Общая информация:	
Заказчик, контактные данные:	
Количество одинаковых заказываемых комплектов:	
Цель приобретения товара (выбрать один вариант):	
☐ для перепродажи; ☐ для использования в составе производимой продукции; ☐ для собственных нужд;	
Параметры потока измеряемой жидкости:	
Наименование жидкости:	Расход, м ³ /час: мин: _____, макс: _____
Диапазон рабочих температур, °С: ☐ от -50 до +75;	Давление, МПа: рабочее: _____, макс: _____
☐ от -50 до +120; ☐ от -50 до +250; ☐ иное: _____	
Диапазон вязкости при рабочих температурах, сСт: ☐ до 50; ☐ до 300;	Наличие твёрдых абразивных частиц: ☐ да; ☐ нет;
Склонность к налипанию: ☐ да; ☐ нет;	Движение потока: ☐ однонаправленное; ☐ реверсивное;
Параметры трубопровода:	
Наружный диаметр, мм: _____ Стенка, мм: _____	Материал: _____
Трубопровод: ☐ существующий; ☐ проектируемый;	
Задача:	
Указать процесс: _____	
Конфигурация:	
☐ расходомер-счётчик: 	☐ расходомер-счётчик дифференциальный: 
☐ расходомер с импульсно-частотным выходом:  ☐ "n-p-n"; ☐ "p-n-p"; ☐ "соленоид";	
Место установки ПИП:	
☐ УХЛ2** ГОСТ 15150-69 (от -55 до +75 °С), IP66; ☐ иное: _____ (указать нужное);	Наличие взрывоопасной зоны: ☐ да; ☐ нет;
Место установки ВЭП:	
☐ УХЛ 3.1** ГОСТ 15150-69 (от -20 до +50 °С), IP65; ☐ УХЛ 2** ГОСТ 15150-69 (от -60 до +50 °С), IP65; ☐ иное: _____ (указать нужное);	Удалённость от ПИП: ☐ до 2,5 метров; ☐ более 2,5 метров, кратно пяти: _____ (указать нужное);
Исполнение ПИП по способу монтажа в трубопровод:	
☐ фланцевое по ГОСТ 33259-2015; ☐ резьбовое по ГОСТ 22525-77 (ISO/DIS8436-6); ☐ линзовое по ГОСТ 9400-81; ☐ кламповое по DIN 32676; ☐ полуфланцевое по ГОСТ Р 50073-92;	☐ грувочное по стандарту AWWAC606-06; ☐ специальное: _____ (указать); ☐ исполнение с минимальной ценой; ☐ требуется консультация специалиста; ☐ требуется комплект монтажных частей для ПИП;
Исполнение ВЭП:	
По напряжению электропитания: ☐ 220 В переменного тока; ☐ 24 В постоянного тока; ☐ иное: _____ (указать нужное);	По наличию дополнительных функций: ☐ выход дозирующий; ☐ выход нормируемый импульсный; ☐ иное: _____ (указать нужное);
Предел относительной погрешности измерения:	
☐ ±1,00 % (эконом); ☐ ±0,50 % (базовый); ☐ ±0,25 % (точный);	
Метрологическое обеспечение:	
☐ заводская калибровка (обычно для технологического учёта)*; ☐ государственная поверка с занесением результатов в ФГИС "Аршин" (важно для коммерческого учёта)*;	

* - калибровка и государственная поверка проводится на воде (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Ф.И.О., подпись, печать Заказчика _____